

手控器

ΗТ

HT手控器主要适用于医疗照护领域,与模帝科大部分的控制盒都相容,具弧度的造型设计提高了用户握持的舒适度。此外,可选用护士锁或安全插销,提高使用的安全性。



产品特性及选项

- 主要应用领域:医疗
- 最多可驱动推杆数:4支
- 最多按键数:10按键
- 防护等级:IPX4

- 壳体颜色: RAL 7035

- LED指示灯 - 附挂勾


- 手控线长:总长880mm含420mm的卷线


- 可选安全插销 - 可选护士锁

- IPX5选项

1


• **HT** 单位: mm

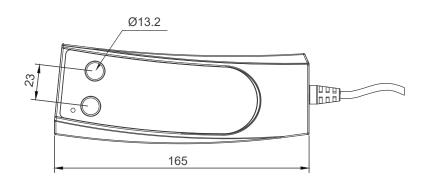








• 配护士锁

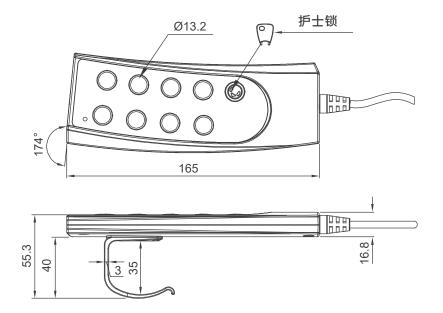




• 配安全插销

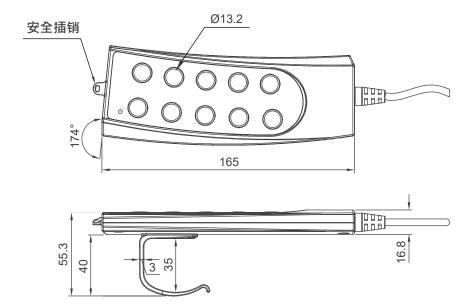



机构尺寸

- 韧体版本A (Moteck P1通讯类别):
 - 按键定义1

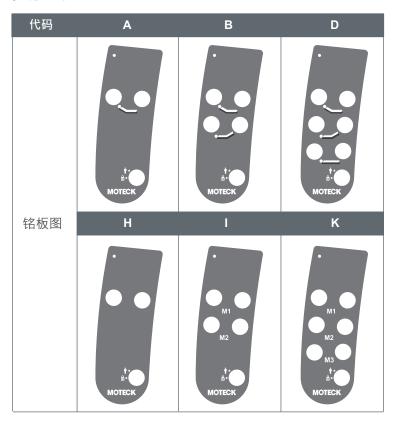


按键定义1:

- ① 无
- ② 无
- ③ 推杆#1伸出
- ④ 推杆#1缩回
- ⑤ 推杆#2伸出
- ⑥ 推杆#2缩回
- ⑦ 推杆#3伸出 ⑧ 推杆#3缩回
- 9 无
- ① 护士锁




- 按键定义2

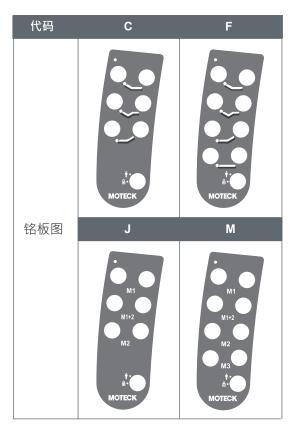


按键定义2:

- ① 推杆#1伸出
- ② 推杆#1缩回
- ③ 推杆#1,#2伸出
- ④ 推杆#1,#2缩回
- ⑤ 推杆#2伸出
- **⑥** 推杆**#2**缩回
- ⑦ 推杆#3伸出
- ⑧ 推杆#3缩回
- ⑨ 无
- 10 护士锁




- 按键定义3



按键定义3:

- ① 推杆#1伸出
- ② 推杆#1缩回
- ③ 推杆#2伸出
- ④ 推杆#2缩回
- ⑤ 推杆#3伸出 ⑥ 推杆#3缩回
- ⑦ 无
- ⑧ 无
- ⑨ 无
- 10 护士锁



- 按键定义4




按键定义4:

- ① 推杆#1伸出
- ② 推杆#1缩回
- (3) 推杆#1·#2伸出
- ④ 推杆#1,#2缩回
- (5) 推杆#2伸出
- ⑥ 推杆#2缩回
- ⑦ 推杆#3·#4伸出
- 8 推杆#3·#4缩回
- 维杆#3伸出,#4缩回
- (ii) 推杆#3缩回,#4伸出




- 韧体版本B (Moteck P2通讯类别):
 - 按键定义5

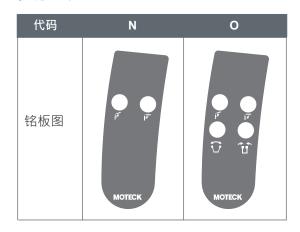

按键定义5:

- ① 无 ② 无 ③ 推杆#1伸出
- 4 推杆#1缩回
- ⑤ 推杆#2缩回 6 推杆#2伸出 7 无

- 8 8 9 10 无




- 按键定义6



按键定义6:

- ① 无
- ② 无 ③ 推杆#1·#2伸出
- (3) 推杆#1·#2 (4) 推杆#1·#2 (5) 无 (6) 无 (7) 无 (8) 无 (9) 无 (10) 护士锁



相容性

产品	型묵	相容条件
控制盒	CBP2, CBP3, CM42, CM43	- Moteck P2通讯类别 - 配Moteck H型5-pin DIN插头
	CB2P, CB4P, MD6C, MD7C, MD80M	- Moteck P1通讯类别 - 配Moteck H型8-pin DIN插头







8-pin DIN 插头



	HT- 04-2-N I 0 0 8
按键数	02: 2按键 04: 4按键 06: 6按键 08: 8按键 10: 10按键
推杆数	1: 1推杆 2: 2推杆 3: 3推杆 4: 4推杆
安全选项	0: 无 N: 护士锁 S: 安全插销 9: 护士锁+安全插销
铭板代码	A~P : 參考 标准铭板选项
保留码	0
保留码	0
电源线长	8: 总长880mm±20mm· 卷线长度420mm

